

# 水分測定装置

## AQ-2200A/AQV-2200A

## AQ-2250/AQV-2250 シリーズ

## をお使いのお客様へ

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。  
日頃よりHIRANUMA製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社では製造中止後の保守部品・消耗品の供給を原則7年とさせていただいており、  
下記のように**保守対応期限が近づいてまいりました。**

| 品名       | 型式        | 製造中止年月   | 保守対応期限          | 後継機種      |
|----------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| 微量水分測定装置 | AQ-2200A  | 2019年7月  | <b>2026年7月</b>  | MOICO-A19 |
| 自動水分測定装置 | AQV-2200A | 2019年7月  | <b>2026年7月</b>  | MOIVO-A19 |
| 微量水分測定装置 | AQ-2250   | 2020年10月 | <b>2027年10月</b> | AQ-2260   |
| 自動水分測定装置 | AQV-2250  | 2020年10月 | <b>2027年10月</b> | AQV-2260  |

お客様には、お早目に機器更新をご検討いただけますよう、何卒よろしくお願ひ申しあげます。  
今後とも、HIRANUMA製品をご愛顧のほどよろしくお願ひ申しあげます。

以上



# 自動滴定装置 COM-1700A/COM-1750 シリーズ をお使いのお客様へ

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。  
日頃よりHIRANUMA製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社では製造中止後の保守部品・消耗品の供給を原則7年とさせていただいており、  
下記のように**保守対応期限が近づいてまいりました。**

| 品名     | 型式        | 製造中止年月  | 保守対応期限         | 後継機種     |
|--------|-----------|---------|----------------|----------|
| 自動滴定装置 | COM-1700A | 2019年4月 | <b>2026年4月</b> | COM-A19  |
| 自動滴定装置 | COM-1750  | 2020年9月 | <b>2027年9月</b> | COM-1760 |

お客様には、お早目に機器更新をご検討いただけますよう、何卒よろしくお願ひ申しあげます。  
今後とも、HIRANUMA製品をご愛顧のほどよろしくお願ひ申しあげます。

以上




COM-1700A



COM-1750  
※Windows11非対応



後継機 COM-A19

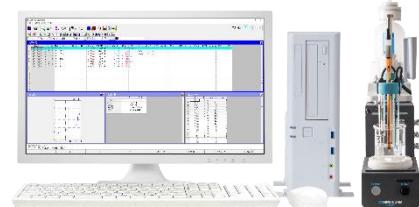

後継機 COM-1760

## 株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739  
東京オフィス・大阪オフィス・名古屋オフィス  
<https://www.hiranuma.com>